
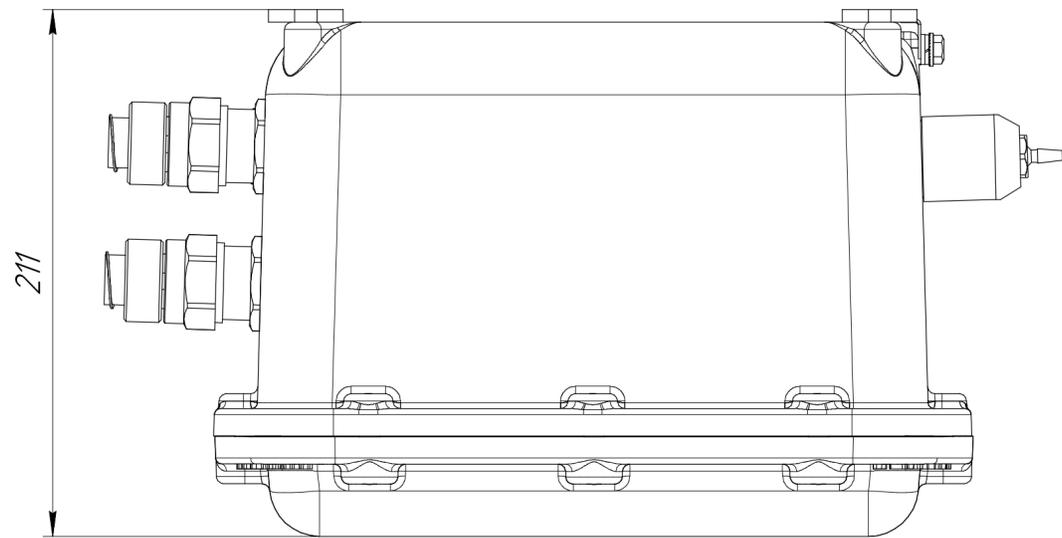
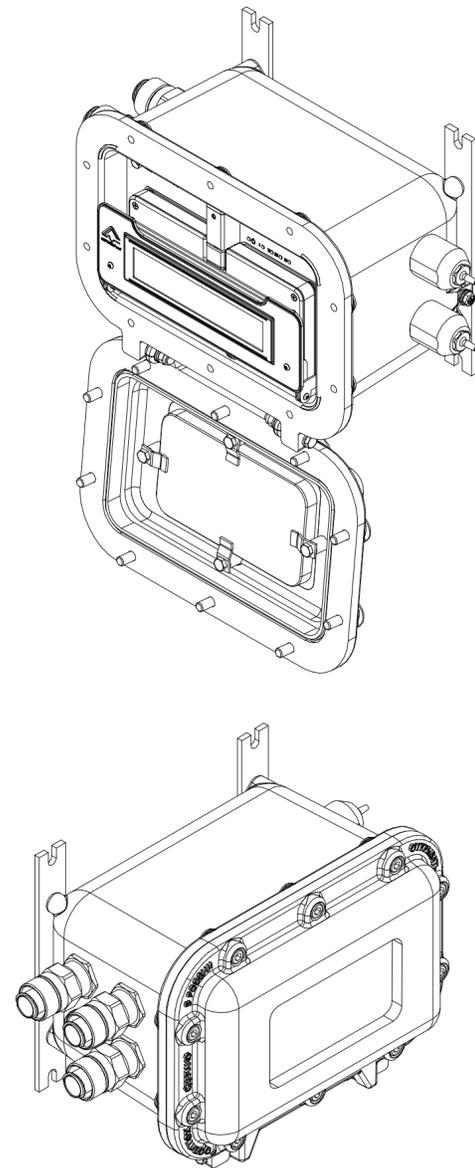


Кабельные вводы
КНВМ2М 3шт

Пламегаситель
с штуцером к трубке $\phi_{\text{внутр}} 6\text{мм}$

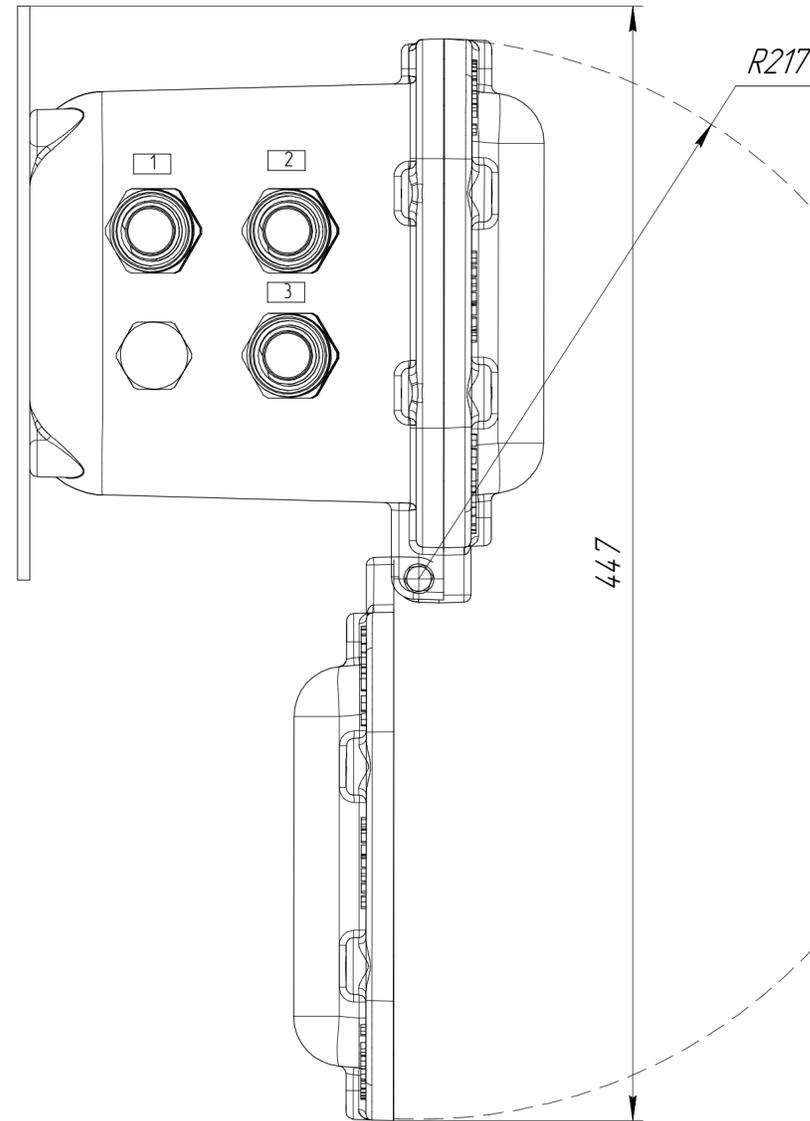

1. Взрывозащита вида 1Ex d IIC T5 Gb X
2. Степень пылевлагозащиты: IP 54
3. Цвет корпуса RAL 7035
4. Вид монтажа: настенный либо стойка с усиленной светозвуковой сигнализацией
5. Питание 24В
6. Кабельные вводы под металлорукав – КНВМ2М
7. Вход выход газовой пробы через пламегасители трубка ПВД $\phi_{\text{внутр}} 5\text{мм}$

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

				КПГУ.1014.00.00.000-02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Лисанко				не более 15	1:2
Проб.		Романовский			Лист	Листов	1
Т.контр.					НПО "ПРИБОР" ГАНК"		
Н.контр.					Копировал		
Утв.		Чекалин			Формат А2		

ГАНК-4ФЕх
Габаритный чертёж